

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

w Poznaniu

im. prof. Ludwika Bierkowskiego



Dział Zamówień Publicznych

ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań

tel. 61-846-47-70

www.szpitalmswia.poznan.pl

efilipiak@szpitalmswia.poznan.pl

Poznań, dnia 26.09.2019 r.

ZP-2374.1.29/2019/EFK

ZP/p/2374-29-752/19

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę wyposażenia dla nowo budowanego bloku operacyjnego i sali wybudzeń oraz centralnej sterylizacji” Część IV.

Nr postępowania: ZP/p/29/19

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ NR 10

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986 ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego informuje, iż do przedmiotowego postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Tym samym Zamawiający udziela następujących odpowiedzi na zadanie zapytania:

ZESTAW ZAPYTAŃ NR 1

**Dotyczy postępowania: „DOSTAWA WYPOSAŻENIA DLA NOWO BUDOWANEGO BLOKU OPERACYJNEGO I SALI WYBUDZEŃ ORAZ CENTRALNEJ STERYLIZACJI”
ZP/p/29/19**

Poz. nr 8 Nóż ultradźwiękowy do preparacji tkanek twardych. 1 szt

Pytanie 1. Czy Zamawiający dopuści nóż ultradźwiękowy do preparacji tkanek twardych o równoważnych parametrach technicznych:

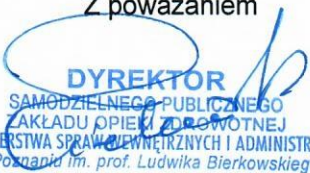
Lp. Opis parametru

- 1 Urządzenie fabrycznie nowe – (nie powystawowe).
- 2 Rok produkcji zgodny z rokiem dostawy
- 3 Parametry
- 4 Waga konsoli 21 kg.
- 5 Nóż ultradźwiękowy do cięcia kości, stosowany w zabiegach resekcji (np. operacje twarzoczaszki, resekcja łuków trzonów kręgu, laminektomia, itp.)
- 6 Końcówki robocze do uchwytu uniwersalnego, umożliwiające aspirację guzów miękkich i twardych z okolic kręgosłupa.
- 7 Możliwość pracy przy użyciu różnych końcówek do tkanek miękkich i twardych (Możliwość zmiany końcówki roboczej w czasie trwania procedury w warunkach sterylnego pola operacyjnego)
- 8 Aparat wyposażony w konsolę, zapewniającą wyświetlanie, oraz niezależną regulację parametrów: wibracji, aspiracji i irygacji podłączonego uchwytu ultradźwiękowego

- 9 Uchwyt o częstotliwości roboczej 25kHz
- 10 Uchwyt wyposażony w przetwornik piezoelektryczny
- 11 Maksymalna amplituda pracy: 365 mikrometrów
- 12 Cienki elastyczny przewód uchwytu o długości 4m
- 13 Wtyk przewodu uchwytu z zatyczką zabezpieczającą styki podczas mycia i sterylizacji
- 14 Uchwyt współpracujący z dwukanałowym zestawem drenów i drenów przedłużających z filtrem ochronnym toru ssącego (hydrofobowa membrana PTFE o średnicy 50mm i rozmiarze porów 0.45mikrometra) zapewniający kanały drenażowe pomiędzy uchwytem a konsolą w celu irygacji i aspiracji o długości całkowitej 5.2m wyposażony w zaciski mocujące kabel uchwytu
- 15 Klucz dynamometryczny wielokrotnego użytku do montażu i demontażu końcówki roboczej
- 16 Kasetka sterylizacyjna z uchwytem do montażu końcówki roboczej i z elastycznymi organizerami na uchwyt, zdejmowalną osłonkę uchwytu, klucz montażowy i wtyk kabla
- 17 Wózek jezdny z platformą nośną konsoli, dolną półką z demontowalnymi uchwytami na zbiornik aspiracyjny oraz szufladą na akcesoria
- 18 Zbiornik wielokrotnego użytku o pojemności 2000ml do jednorazowych wkładek aspiracyjnych - 1 szt.
- 19 Przednie kółka wyposażone w hamulce
- 20 Wysokość wózka: 97cm
- 21 Jednoprzyciskowy sterownik nożny
- 22 Jednorazowa wkładka zbiornika aspiracyjnego (op 5 szt)
- 23 Sterylny jednorazowy dwukanałowy zestaw drenów i drenów przedłużających z filtrem (op. 5szt.)
- 24 Końcówki robocze do uchwytu uniwersalnego:
- 25 Końcówka robocza prosta: długość krawędzi tnącej 12,4mm grubość końcówki tnącej 0,8mm - 2 szt.
- 26 Końcówka robocza do wygładzania kości typu Payner 360: długość całkowita 9.9 mm, długość części tnącej 2.7 mm, szerokość części tnącej 3.12 mm
- 27 Końcówka robocza typu "Pazur": długość całkowita 9,7 cm, długość części tnącej 2 mm, szerokość krawędzi tnącej 2.8 mm
- 28 Końcówka robocza przedłużona typu "mikro pazur": długość całkowita 11,7 cm, długość części tnącej 1.2 mm szerokość części tnącej 2 mm.
- 29 Zasilanie: 230 VAC 50/60Hz

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na powyższe.

Niniejszy dokument stanowi integralną część SIWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego.

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
MINISTERSTWA SPRAW WNETRZNYCH I ADMINISTRACJI
w Poznaniu Im. prof. Ludwika Bierkowskiego

dr n. med. Witold Pstrąg-Bieleński

Wyk. w 1 egz.
1/ strona internetowa
1/ a/a
Druk: EFK